SCAN FOR VIDEO

Quick guides

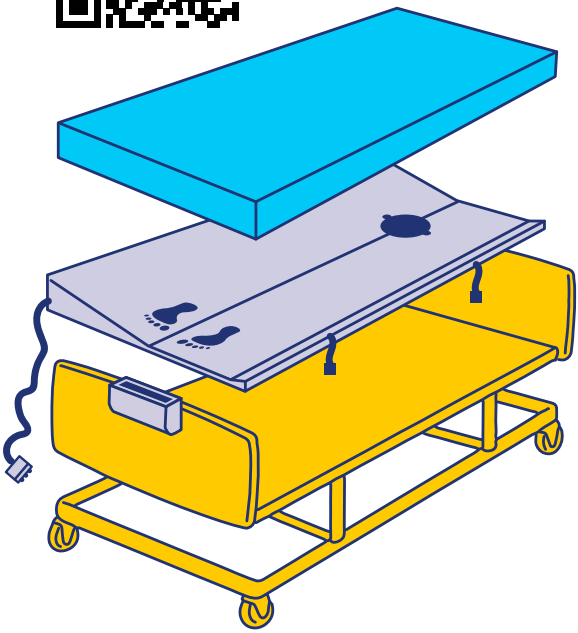

turnall®

Sistema de giro lateral automatizado 1C - 3C

ES

Patentado

CE

LEVABO® medical

Contenido del sistema Turn All®

1 pieza. Sistema de bombeo Turn All® 1C
O
1 pieza. Sistema de bombeo Turn All® 3C
1 pieza. cable de alimentación del sistema de bombeo
1 pieza. Colchón de elevación Turn All®
1 pieza. Funda Turn All® El colchón elevador se suministra premontado dentro de la funda
1 pieza. manual de usuario.

Sobre el uso y la instalación del sistema

Este manual del usuario proporciona información importante sobre el trabajo con el sistema Turn All®.

Por favor, lea las instrucciones antes de intentar utilizar este aparato.

Este manual de instrucciones forma parte del producto y debe mantenerse cerca del sistema para que pueda ser consultado en cualquier momento por el personal y los operarios.

Si el sistema se transfiere a un tercero, las instrucciones deben acompañarlo.

Las ilustraciones de estas instrucciones tienen por objeto proporcionar una demostración clara de la situación actual y, por lo tanto, no se ajustan necesariamente a la escala correcta, pudiendo variar ligeramente con respecto al diseño real del dispositivo.

Toda la información y los consejos de este manual se han preparado de acuerdo con las normas aplicables.

Table of contents

Contenido del sistema Turn All® 2
Sobre el uso y la instalación del sistema 2
Sobre el posicionamiento de los pacientes y el sistema Turn All® 4
Función del sistema Turn All® 5
Instalación del sistema Turn All® 6
Colocación del sistema Turn All® en una cama 6
¡Información importante! Con respecto a la conexión de la manguera..... 6
Puesta en marcha y ajuste del sistema Turn All® 8
Uso del sistema Turn All® para la elevación estática 9
Indicaciones y contraindicaciones..... 10
Usos / lugares permitidos 11
Seguridad..... 12
Provisiones de garantía y responsabilidad..... 13
Limpieza y desinfección..... 14
Notificación de sucesos accidentales 16
Datos técnicos 16
Homologaciones, normas y reglamentos 17
Gama de productos Turn All® 18
Explicación de los símbolos en el envase..... 18
Declaración de conformidad (CE) 18
Mantenimiento..... 19
Solución de problemas..... 19
Preguntas frecuentes..... 19
Consejos 20

Sobre el posicionamiento de los pacientes y el sistema Turn All®

Las úlceras por presión son zonas de la piel en las que la piel o el tejido subyacente están dañados. En caso de inmovilidad y riesgo de daños en la piel, las úlceras por presión pueden producirse en un plazo de 10 a 15 minutos, por lo que es importante realizar un esfuerzo rápido y preventivo. La mayoría de las úlceras por presión pueden prevenirse.

Las úlceras por presión pueden producirse en cualquier parte del cuerpo, pero son especialmente vulnerables los lugares del cuerpo donde las protuberancias óseas aumentan la presión contra el sustrato. Por lo tanto, es importante centrarse en el alivio de estas zonas vulnerables en la prevención de las úlceras por presión.

Las personas mayores y los pacientes encamados corren un riesgo especial de desarrollar úlceras por presión.
La parálisis, el mal estado nutricional y enfermedades como la diabetes y la aterosclerosis también aumentan el riesgo de úlceras por presión. Las personas de alto riesgo son aquellas que no pueden cambiar o pedir un cambio de posición por sí mismas.

Por lo tanto, es importante para la prevención de las úlceras por presión que los familiares o el personal giren y alivien con frecuencia a los pacientes en posición supina y sentada. Al mismo tiempo, es importante evitar la fricción contra el sustrato, que puede provocar cizallamiento (desprendimiento de la piel). La necesidad de alivio y reversión es individual, pero el intervalo más frecuente para la reversión es de 1½ - 2 horas.

El sistema Turn All® que puede girar automáticamente al paciente es una gran ayuda.

El sistema libera recursos del cuidador, ayudando así tanto al personal como a los pacientes.

Ventajas del sistema Turn All®

- Alivio integral de la presión
- Prevención de lesiones/úlceras por presión
- Tratamiento de lesiones / úlceras existentes
- Cómodo y no interrumpe el sueño normal
- Silencioso cuando se utiliza
- Los pacientes bariátricos/pesados pueden girarse con cuidado y facilidad, protegiendo así la salud y el bienestar del personal que trabaja con ellos
- Visión completa, ya que el paciente siempre está tumbado de espaldas en el colchón
- Posicionamiento suave incluso para pacientes con dolor
- La ligera elevación del colchón, en el lado inverso al de la elevación primaria, proporciona apoyo y seguridad, además de disminuir el riesgo de cizallamiento, véase la figura. página 5
- El ahorro de tiempo se traduce en más tiempo de atención disponible para el paciente
- Mejora el microclima y la circulación sanguínea
- Robusto, duradero y fiable
- Se puede integrar en cualquier cama con colchones extraíbles.

Función del sistema Turn All®

Modo dinámico - Automático

El sistema Turn All® es un sistema de posicionamiento lateral automático, para el paciente que necesita prevenir o tratar las úlceras por presión.

El posicionamiento se realiza de forma sencilla y silenciosa. El sistema tarda aproximadamente entre 7 y 14 minutos en cambiar de posición. Debido a este cambio de posición tan lento y uniforme, el sistema es percibido como muy cómodo por el paciente.

El sistema se basa en un sistema de cámara de aire que eleva al paciente tumbado en ella alternativamente por el lado derecho y el izquierdo.

De este modo, el sistema coloca al paciente en una posición lateral de 30º, alternativamente a la derecha y al lado izquierdo.

Modo estático - Ajuste manual

En el modo estático, el sistema se utiliza como un cojín inclinado (sin automatización), donde la inclinación se controla manualmente de 0 a 30°. La pendiente se determina por la cantidad de aire que se bombea en el sistema.

Posición lateral estática, como un cojín.

La siguiente ilustración muestra la secuencia del posicionamiento automático en el sistema Turn All®.

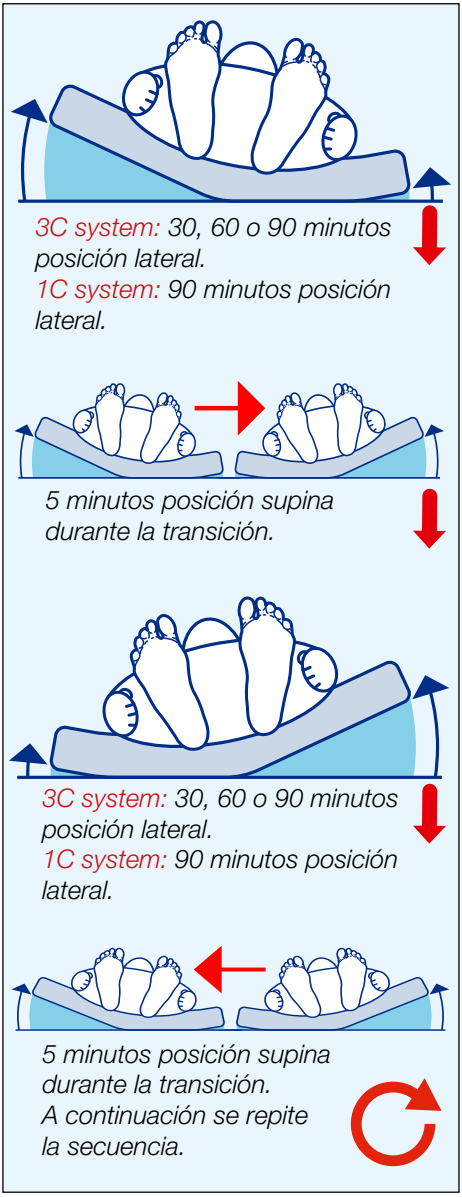

Instalación del sistema Turn All®

Colocación del sistema Turn All® en una cama

Retire el colchón de la cama (Figura 1).

Coloque el sistema Turn All® (A) en el somier, orientando el sistema de forma que la conexión de la manguera (B) quede en el extremo de los pies de la cama (figura 1.2).

Fije el sistema Turn All® al somier mediante las correas (H) de la funda (figura 1.2).

Vuelva a colocar el colchón en la cama sobre el sistema Turn All® (figura 1.3).

Coloque la bomba Turn All® (C) en el extremo de la cama utilizando los dos tirantes de la parte posterior de la bomba (figura 1) (figura 1.3).

Inserte la conexión de la manguera (B) en la bomba (C) (Figura 2) y (Figura 3) página 7.

Figura 1

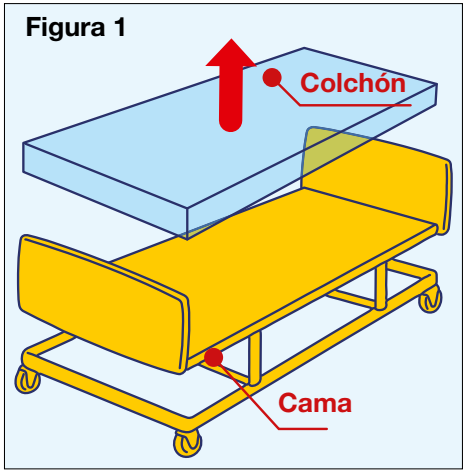

Figura 1.2

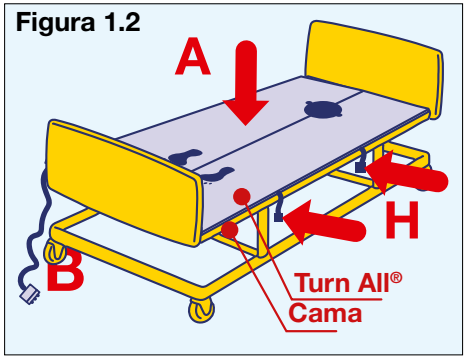

Figura 1.3

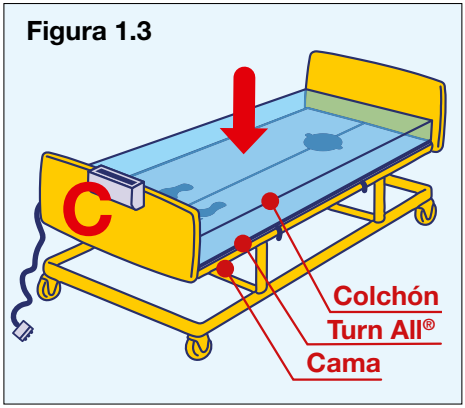

¡Información importante! Con respecto a la conexión de la manguera

Al inicio del sistema:
La orientación de la conexión de la manguera (B) determina qué lado del colchón se eleva primero.
Esto es importante si el sistema se va a utilizar para la elevación estática del paciente por un lado, como un cojín inclinado.
Consulte la sección “Uso del sistema Turn All® para la elevación estática” en la página 9.

La conexión de la manguera (B) está marcada con las letras “R” para la derecha y “L” para la izquierda.

Si la elevación debe comenzar en el lado derecho de la cama, visto desde el extremo de los pies, la conexión de la manguera con la letra “R” se gira hacia el texto “Lado de inicio” en la bomba, como se muestra en (Figura 2).

Si la elevación debe comenzar en el lado izquierdo de la cama, visto desde el extremo de los pies, la conexión de la manguera con la letra “L” se gira hacia el texto “Lado de inicio” en la bomba, como se muestra en la (Figura 3).

Después del primer uso del sistema, el lado de puesta en marcha será arbitrario, pero si se desea cambiar el lado de elevación, la bomba se apaga durante 3 segundos, después de lo cual el sistema cambia el lado de elevación y continúa con el seleccionado. secuencia de giro.

Figura 2 **Levantar el lado derecho**

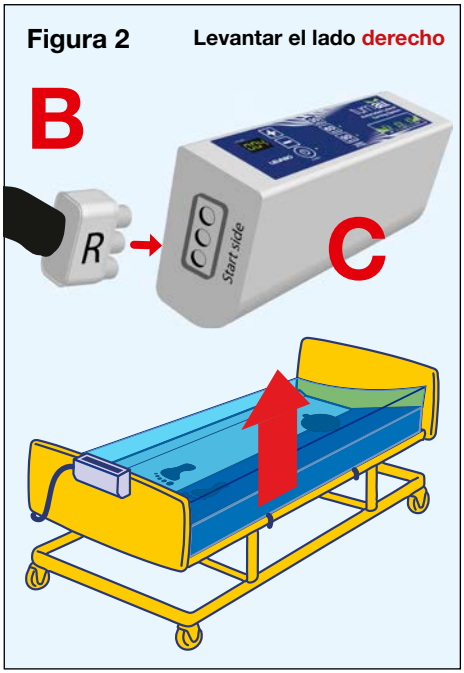

Figura 3 **Levantar el lado izquierdo**

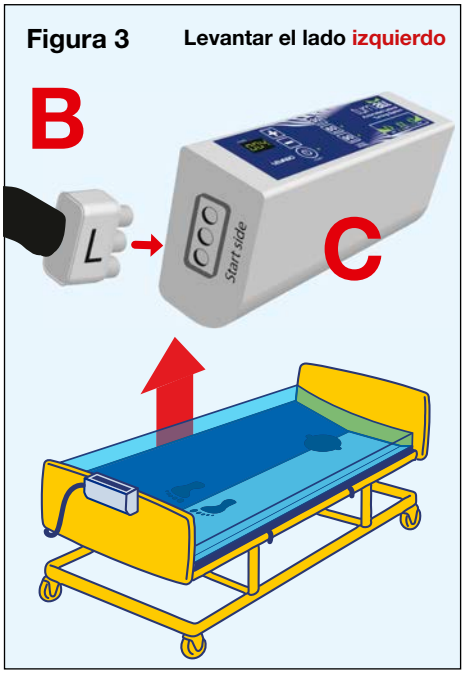

Puesta en marcha y ajuste del sistema Turn All®

Conecte el cable de alimentación a la bomba (Figura 7)
Conecte el cable de alimentación a la red eléctrica.

Encienda la bomba con el botón “POWER” (D) (Figura 4).

Ajuste el temporizador “G” con los botones “+” y “-”.

El número del temporizador “G” indica el número de horas que el sistema debe funcionar automáticamente.

3 El sistema Turn All® funciona ahora automáticamente. Un lado del colchón se levanta ahora durante 30/60/90 minutos (Sistema 1C 90 minutos), luego se acuesta en posición horizontal durante 5 minutos durante la transición, luego el otro lado se levanta durante 30/60/90 minutos (Sistema 1C 90 minutos), luego se acuesta en posición horizontal durante 5 minutos durante la transición.

Esta secuencia se repite durante el número de horas ajustado en el temporizador “G”, y luego se vuelve a colocar en posición horizontal. Véase la ilustración de la página 5 de la guía del usuario.

Figura 4

Uso del sistema Turn All® para la elevación estática

Si el sistema Turn All® se va a utilizar para una elevación estática como cojín inclinado, la conexión de la manguera se invierte según el lado que se vaya a elevar.

Consulte la sección ”¡Importante! Sobre la conexión de la manguera ”página 7.

La bomba se pone en marcha y se bombea hasta alcanzar la altura de elevación deseada.

A continuación, desconecte la conexión de la manguera (B) de la bomba (C) (Figura 5).

La conexión de la manguera (B) se cierra ahora con la tapa (E) (Figura 6).
Cuando la tapa (E) está montada en la conexión de manguera (B), la bomba (C) se apaga con el botón ”POWER” (D).

El sistema Turn All® permanecerá ahora en esta posición hasta que se vuelva a retirar la tapa (E) y se elimine así el aire del sistema.

Asegúrese de que las cámaras de aire están completamente vacías antes de volver a conectar la conexión de la manguera (B) a la bomba (C).

Figura 5

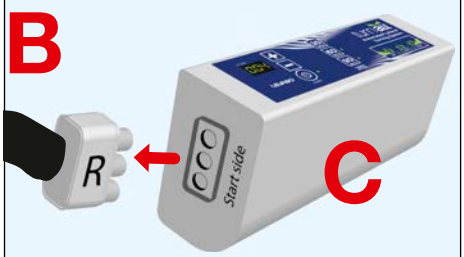

Figura 6

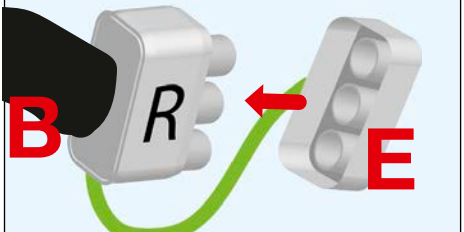

Figura 7

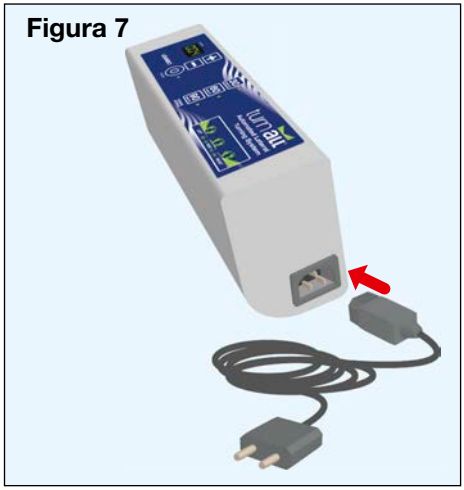

Indicaciones y contraindicaciones

Indicaciones / Finalidad

Prevención y tratamiento de las úlceras por presión.
Úlceras por presión existentes y riesgo de desarrollo de úlceras por presión.
Riesgo de úlceras por presión.

El sistema Turn All® puede utilizarse en camas con o sin superficies ajustables.

Cuando se utilice el sistema Turn All® en camas con superficies ajustables, asegúrese de seguir las directrices para evitar el cizallamiento.

El sistema Turn All es adecuado para la prevención de las úlceras por presión, incluidos todos los niveles de riesgo de daño cutáneo.

El producto puede utilizarse con todos los grados de úlceras por presión.

Sin embargo, es importante consultar a la persona responsable del tratamiento y seguir sus recomendaciones.

El sistema Turn All 1C / 3C está diseñado para pacientes con un peso corporal de hasta 225 kg.

El sistema Turn All Bariatric 3C está diseñado para pacientes con un peso corporal de hasta 400 kg.

El sistema Turn All® es adecuado y recomendable:

- Para personas inmóviles con riesgo de úlceras por presión de moderado a alto, según la escala de Braden
- Para personas cuya discapacidad o enfermedad les obliga a pasar largos periodos tumbados
- Para personas que no pueden ca biar de posición cuando están tumbadas
- -Para personas que han sufrido un ictus con parálisis parcial
- Para personas con lesión medular que desean cambiar de posición al acostarse, utilizando sus brazos.

Contraindicaciones / Riesgos de uso / El producto no puede utilizarse

- Pacientes móviles que se giran en la cama.
- Fracturas inestables
- Lesiones graves por quemaduras.
- Trastornos del equilibrio
- Enfermedades neurológicas suby centes que provocan comportamie tos de ansiedad en los pacientes.

Usos / lugares permitidos

El sistema Turn All® puede utilizarse en todas las camas con colchón extraíble.

El sistema Turn All® puede utilizarse para el mismo paciente durante un periodo de tiempo prolongado.

El sistema Turn All® es una ayuda para la prevención de las lesiones por presión y una terapia auxiliar para el tratamiento de las lesiones por presión.

Incluso con el uso del sistema Turn All®, la piel debe ser examinada regularmente por los cuidadores y/o personal médico cualificado con conocimientos sobre las lesiones por presión

Nota. Quedan excluidas las reclamaciones de cualquier tipo por daños resultantes de un uso incorrecto o inadecuado.
Es el operador el único responsable de todos los daños en caso de uso incorrecto o inapropiado.

Seguridad

Esta sección proporciona una visión general de los aspectos de seguridad importantes, para una protección óptima de los pacientes y los cuidadores, así como un uso seguro y sin problemas del sistema.

Si el sistema Turn All® se utiliza en una cama con barandillas, la barandilla de la cama debe estar 220 mm más alta que el colchón en posición horizontal.

El sistema Turn All® es una ayuda para la prevención de las lesiones por presión y una terapia auxiliar para el tratamiento de las lesiones por presión.

Incluso con el uso del sistema Turn All®, la piel debe ser examinada regularmente por los cuidadores y/o personal médico cualificado con conocimientos sobre las lesiones por presión.

Nota. El operador es el único responsable de todos los daños en caso de uso incorrecto o inadecuado.

Aviso de advertencia

Si la bomba se desconecta de la red eléctrica durante su funcionamiento o si se produce un corte de corriente, sonará una señal de advertencia acústica durante aproximadamente 5 minutos. La señal de advertencia puede cerrarse pulsando la tecla “POWER” (D) (Figura 4) página 8.
A continuación, reinicie el sistema.

La ubicación de la bomba y el emplazamiento del cable de alimentación deben elegirse de forma que se excluya una desconexión involuntaria de la red de suministro. El cable de alimentación debe ser guiado de tal manera que no pueda ser pellizcado o aplastado. También debe guiarse de manera que no suponga un riesgo de tropiezo.

Función RCP

Si se produce una emergencia médica, puede ser necesario un desinflado rápido.

Para ello, tire de la tira roja marcada como CPR para que se abran las conexiones de la manguera al colchón. Véase la ilustración siguiente.
Al desconectar esta conexión, las cámaras de aire se vaciarán rápidamente y la cama volverá a la posición horizontal.

Este proceso puede acelerarse aún más presionando el colchón.

Asegúrese de que las cámaras de aire se vacían completamente antes de volver a conectar la conexión CPR.

A continuación, reinicie el sistema.

Elevación de la cama asistencial

El sistema admite la posición elevada de la cama asistencial en las partes de la cabeza y los pies. Sin embargo, aquí hay que prestar atención a la posición y la postura correctas del paciente asistencial. Esto dependerá de la forma del cuerpo y del cuadro clínico. En caso de dudas o preguntas, consulte con el médico tratante o con el personal sanitario especializado.

Con la cabecera de la cama elevada, es importante asegurarse de que se evita que el paciente se caiga hacia delante.

Dependiendo de la forma del cuerpo, sólo se debe utilizar un cojín para la cabeza de forma adecuada.

La elevación máxima de la cabecera de la cama debe ser de 20º-30º, pero si es necesario la cabecera de la cama puede estar más alta durante periodos cortos/ largos para la situación de comer y beber.

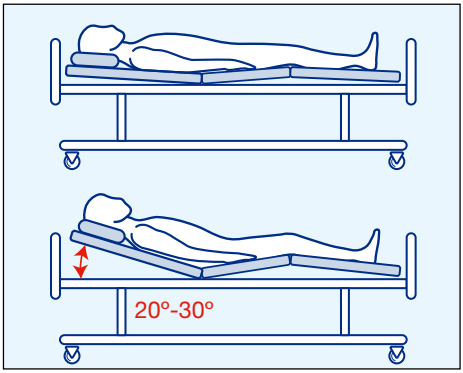

Provisiones de garantía y responsabilidad

Si se utiliza correctamente, Levabo ApS ofrece una garantía de 24 meses a partir de la fecha de la factura.

Durante este periodo, las piezas defectuosas serán reparadas o sustituidas gratuitamente por defectos de fabricación.

Levabo ApS no asume ninguna responsabilidad por daños debidos a:

1. **No seguir las instrucciones de uso**
2. **El uso no conforme con las instrucciones**
3. **Cambios no autorizados**
4. **Cambios técnicos**
5. **Uso de piezas de repuesto no autorizadas.**

La garantía se basa en las disposiciones y directivas legales.

Si se interviene el sistema sin la aprobación previa de Levabo ApS, la garantía se extingue.

Si se reclama la garantía y si, tras la comprobación, se demuestra que se trata de signos de desgaste u otro tipo de daños no cubiertos por la garantía, Levabo Aps tiene derecho a transferir al cliente los gastos ocasionados (pruebas, costes de transporte y similares).

Limpieza y desinfección

Limpieza del sistema Turn All®

Turn All® Cover
(la cubierta exterior azul)

El colchón elevador interno debe retirarse de la Turn All® Cover antes de lavarla. véase la página 15.

Turn All® Cover puede lavarse en la lavadora a 95° C. y en la secadora a baja temperatura.

Turn All® Cover puede lavarse en autoclave v. Máx. 121° C.

El sistema Turn All® debe desconectarse de la red eléctrica antes de su limpieza.

Si el sistema Turn All® se ha contaminado con fluidos corporales, puede limpiarse.

El colchón interior Turn All® Multi Patient puede limpiarse con agua tibia y jabón. La desinfección puede realizarse con una solución apropiada a base de cloro al 1%.

La caja de control Turn All® puede rociarse con un desinfectante adecuado o con alcohol / alcohol propílico en un paño húmedo para limpiarla.

Nota. No utilice limpiadores cáusticos o abrasivos ni objetos afilados para limpiar el sistema Turn All®.

Si el sistema Turn All® necesita ser limpiado, puede sacar el colchón interior (H) figura 1, abrir la cremallera de la cubierta (J) figura 1 y retirar la parte superior.

Figura 1

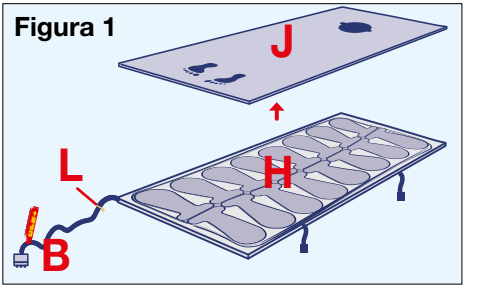

Abra la cremallera (L) figura 1 y tire de los tubos de conexión (B) figura 1-2) a través de la abertura en la parte inferior de la cubierta.

Figura 2

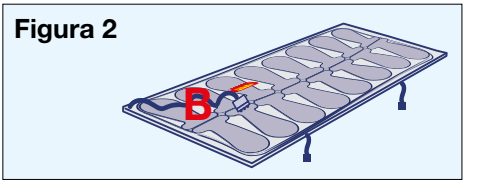

Losen los 6 kamsnaps (K) Figura 3.

Figura 3

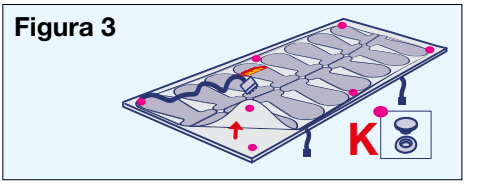

Ahora se puede retirar el colchón interior (H), según la figura 4. El colchón limpio se monta como se muestra en el orden inverso.

Figura 4

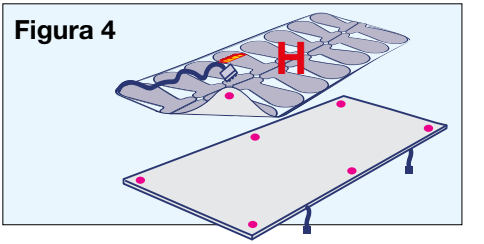

Notificación de sucesos accidentales

Las averías o el mal funcionamiento del aparato que hayan causado daños personales deben notificarse inmediatamente a la autoridad competente y a la empresa Levabo ApS.

Nota. La autoridad competente puede exigir que el operador sea notificado del incidente por un experto a su cargo y que presente la evaluación por escrito. El experto se seleccionará de acuerdo con la autoridad competente.

La evaluación técnica de la seguridad incluye los siguientes elementos

- A qué puede atribuirse el suceso
- Si el producto estaba en buen estado
- Si existe algún otro peligro tras la reparación del mal funcionamiento
- Si se han obtenido nuevos conocimientos que requieran otras o nuevas precauciones.

Datos técnicos

Dimensiones (L x B x H)
Funda:.....200 x 85 x 15 cm
Colchón de elevación .....200 x 85 cm
Bomba: .....8 x 27 x 13,5 cm

Veight
Bomba: ..... 1.5 Kg
Colchón con funda: ..... 4 Kg

Ángulo de elevación
Dinámico (automático): .....30˚
Estático (manual): .....0˚ - 30˚

Datos eléctricos
Tensión de red: 240V
Frecuencia:..... 50Hz / 60Hz
Consumo de energía: .....Max. 12 W
Clasificación: .....Klasse II
Fusible:..... T500mA L250V

Almacenamiento
-10º to 50º Celcius.
Humedad relativa del 0% to 95% sin condensación.

Condiciones de uso
Diseñado para un funcionamiento continuo.
Temperatura de aplicación:
0 ° to 40 ° Celcius.
Humedad relativa del 20% to 95% sin condensación.

Normas
Ver homologaciones en la página 16.

Homologaciones, normas y reglamentos

Cubrir la parte superior
Medical BI ELASTIC PES PU

Antibacteriano y antifúngico:
ISO 22196:2011 - **PASS**

Inflamabilidad BS 7175 fuente de ignición 5
Tratamiento previo: Ninguno
Método de prueba: BS 7175: 1989 (2013) Sección 3 - **PASS**

Inflamabilidad BS 7175 fuente de ignición 5
Tratamiento previo: Ninguno
Método de prueba: BS 7175: 1989 (2013) Sección 3 - **PASS**

Inflamabilidad BS 7177: 2008 + A1: 2011 Peligro bajo
Método de prueba: BS EN 597-1: 1995 y BS EN 597-2: 1995 - **PASS**

EN 1021-1-2: - **PASS**

Parte inferior de la cubierta TPU
Negro ignífugo
Tejido de dacrón con revestimiento de TPU 600D.

Antibacteriano y antifúngico:
ISO 22196:2011 - **PASS**

Inflamabilidad BS 7175 fuente de ignición 5
Tratamiento previo: Ninguno
Método de prueba: BS 7175: 1989 (2013) Sección 3 - **PASS**

Inflamabilidad BS 7177: 2008 + A1: 2011 Peligro bajo
Método de prueba: BS EN 597-1: 1995 y BS EN 597-2: 1995 - **PASS**

EN 1021-1-2: - **PASS**

Bomba

Probada y aprobada de acuerdo con:
IEC 60601-1: 2006 +A1: 2013:
Requisitos generales de seguridad básica y rendimiento esencial.

Probada y aprobada de acuerdo con:
EN60601-1-2: 2007
Requisitos generales para la seguridad básica y las prestaciones esenciales, norma colateral: Compatibilidad electromagnética.

Probado y aprobado de acuerdo con:
IEC 60601-1-11: 2015 (2. Edición) para su uso junto con IEC 60601-1:2012 (3. Edición) + A1: 2012
Requisitos generales para la seguridad básica y las prestaciones esenciales, Norma colateral: Requisitos para los equipos médicos eléctricos y los sistemas médicos eléctricos utilizados en el entorno sanitario doméstico.home healtcare environment.

Cambio del filtro en la bomba

1. En la parte trasera de la bomba hay una tapa



2. Abra la tapa

3. En el interior de la tapa se encuentra el filtro, sustituya el filtro y monte en orden inverso.

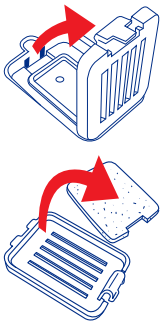

Gama de productos Turn All®

Nombre del producto	Tamaño en cm.	Peso máximo en Kg.	Nº de artículo	Aplicación
Sistema Turn All® - TPU 3C para varios pacientes	85 x 200	225	70128	Sistema que contiene el colchón elevador Turn All®, 1 funda Turn All® con parte inferior de TPU, y 1 bomba, 3 ciclos: 30/30, 60/60, 90/90 minutos.
Funda Turn All® TPU Funda para el colchón Turn All®	85 x 200	N/A	70114	Funda para el colchón elevador Turn All® con parte inferior de TPU.
Bomba Turn All® 3C	27 x 13 x 10	N/A	76117	Bomba para el Sistema Turn All®, 3 ciclos: 30/30, 60/60, 90/90 minutos.
Bariatric				
Sistema Turn All® Bariátrica - TPU 3C para varios pacientes	110 x 210	400	70098	Sistema que contiene el colchón elevador Turn All®, 1 funda Turn All® con parte inferior de TPU, y 1 bomba, 3 ciclos: 30/30, 60/60, 90/90 minutos.
Funda para el colchón Turn All® Bariátrica TPU	110 x 210	NA	70126	Funda para el colchón de elevación Turn All® Bariatric con parte inferior de TPU.

Explicación de los símbolos en el envase

Explanation of symbols on the packaging					
	Lea la guía del usuario		Fecha de caducidad	CE	Conformité Européenne
LOT	Número de producción	REF	Número de producto	5 PP	Material del envase
	Fabricante		Fecha de fabricación	MD	Dispositivo médico

CE

Declaración de conformidad (CE)
La empresa Levabo ApS,
Sverigesvej 20A, 8660 Skanderborg, declara que los productos están diseñados y fabricados de acuerdo con la documentación técnica y los requisitos legales.

Producto
Turn All® es un producto médico activo de acuerdo con: Regla mento de la UE MDR (UE) 2017/745, Productos sanitarios - Clase 1.
Controlado por
Agencia Danesa del Medicamento
21/1 2021

Producción
EN ISO 9001: 2015 QMC
EN ISO 13 485: 2016 MD-QMC

Mantenimiento

Colchón Turn All®

El colchón debe limpiarse con regularidad, véase la página 14 sobre limpieza

Bomba Turn All®

La caja de control de Turn All® puede limpiarse con un desinfectante adecuado o con alcohol/alcohol propílico en un paño húmedo para secarlo.

El filtro de la bomba debe cambiarse una vez al año, véase la página 17

Solución de problemas

La bomba no arranca

Compruebe que el cable está bien enchufado en la bomba y en la toma de corriente y que la toma de corriente está encendida

El colchón no se levanta pero la bomba está en funcionamiento

Compruebe que el acoplamiento de la manguera está bien conectado a la bomba.
Compruebe que la ventilación de la RCP está bien cerrada

La bomba no bombea como se espera

Apague la bomba, desenchúfela y espere 10 minutos.
Conecte la bomba a la toma de corriente y enciéndala.

Preguntas frecuentes

¿Qué cama necesito para instalar el sistema Turn All®?

El sistema Turn All® puede integrarse en una cama estándar con un colchón extraíble.

¿Cómo se limpia el sistema Turn All®?

La funda del Turn All® (la funda azul) es lavable y se puede lavar en la lavadora a 90° C. y secar en secadora a baja temperatura.
Nota: El colchón elevador interior no se puede lavar a máquina. El colchón de elevación interior puede lavarse con agua tibia y jabón.
La desinfección se puede realizar con una solución adecuada a base de cloro al 1% en un paño húmedo para limpiarlo.

¿Cuáles son las dimensiones de Turn All®?

(L x A x H)
Funda: 200 x 85 x 15 cm
Colchón de elevación: 200 x 85 cm
Bomba: 8 x 27 x 13,5 cm

¿Cuánto pesa Turn All®?

Bomba: 1,5 kg
Colchón con funda: 4 kg

¿Cuál es el peso máximo del usuario para Turn All®?

El sistema Turn All 1C / 3C está diseñado para pacientes con un peso corporal de hasta 225 kg.

El sistema Turn All Bariatric 3C está diseñado para pacientes con un peso corporal de hasta 400 kg.

Consejos

Cambiar el lado de elevación

Si la bomba levanta en el lado opuesto al que usted desea, apague la bomba, espere unos segundos, encienda la bomba de nuevo y levantará en el lado opuesto.

Baño en la cama

Al lavar a los pacientes encamados, Turn All® puede ser una gran ayuda para poner al paciente en posición lateral de 90° para el lavado y la higiene personal.

Turn All userguide 1C-3C ES 2022.12.13 Rev.4

LEVABO® medical

www.levabo.com
www.facebook.com/LevaboAps

Levabo ApS
Sverigesvej 20
8660 Skanderborg DK